GLOBUS

ITALIAN EXCELLENCE

PressCare G280

Compression therapy. Wherever you are.

Használati útmutató



CE

Ez a kézikönyv a Domino Srl tulajdonát képezi

A Domino Srl hozzájárulása nélkül szigorúan tilos a kézikönyv bármilyen formában történő sokszorosítása, nyilvánosságra hozatala, bármely nyelvre történő fordítása, továbbítása és másolása, akár részben is, beleértve a mágneses adathordozókon vagy gépelt formában történő tárolást is, harmadik felek részére.

A használati útmutató tárolása

A használati útmutatót megfelelő helyen, minden esetben a termék használatának helyszínén kell tárolni. A dokumentumot a termék teljes élettartama alatt meg kell őrizni, hogy minden esetleges igény esetén megfelelő hivatkozási alapként szolgálhasson.

A **PressCare G280** sorozatú készülékeket a következő gyártó állítja elő:

Xiamen Healthpal Electronic Co., Ltd
Cím: No. 148 Binglangxili, Siming District, Xiamen, Fujian, Kína

Tel.: 0086-592-5326750
Fax: 0086-592-5360446
E-mail:sales@xmhealthcare.com
Web: www.xmhealthcare.com

Forgalmazó:

Domino S.r.l.
via Vittorio Veneto, 52 31013 Codognè (TV), Olaszország

Tel.: (+39) 0438.7933
Fax: (+39) 0438.793363
E-mail:info@globusitalia.com
Weboldal: www.globuscorporation.com

Információkérés és műszaki támogatás

Ha segítségre van szüksége a felhatalmazott szakemberektől, vagy további információra van szüksége a termékkel kapcsolatban, illetve a jelen kézikönyvben nem tárgyalt kérdésekben, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Domino Srl céggel az alábbi elérhetőségeken:



+3904387933

+39348 900 4988



info@globusitalia.com



www.globuscorporation.com

Általános tartalomjegyzék

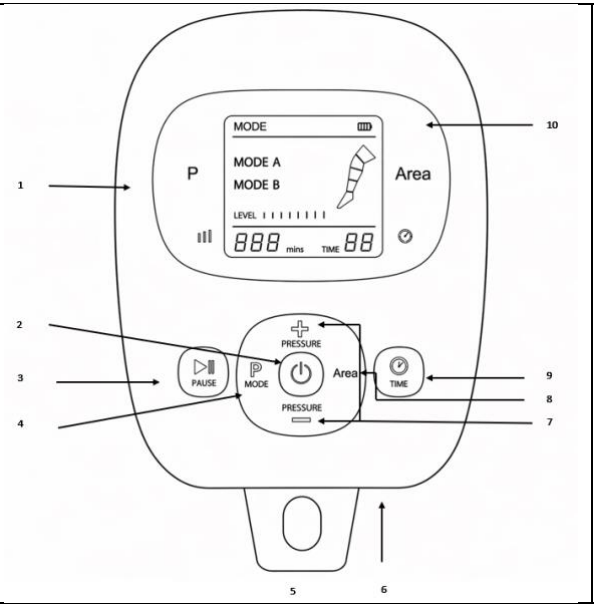
1. Műszaki adatok 6
   1.1. Termékleírás 6
   1.2. Termékváltozatok 7
   1.3. Üzemeltetési feltételek 7
   1.4. Tárolási, kezelési és szállítási feltételek 7
2. Garanciális feltételek 8
3. Javasolt felhasználás 8
4. A készülék besorolása 9
5. Figyelmeztetések és ellenjavallatok 9
   5.1. Kötelező magatartás 9
   5.2. Használat előtti óvintézkedések 9
   5.3. Használat közbeni óvintézkedések 10
   5.4. Ellenjavallatok 10
   5.5. Mellékhatások 11
6. Hatásmechanizmus 11
7. Berendezések és kiegészítők 11
   7.1. Alapfelszerelés 12
   7.2. Kiegészítők 12
8. A készülék használatra való előkészítése 13
9. Előre beállított programok 13
   9.1. Kezelési gyakoriság 14
10. Használati utasítás 14
11. Tisztítás és karbantartás 15
   11.1. Tisztítás 15
   11.2. Tárolás 16
   11.3. Ártalmatlanítás 16
12. Címkézés és szimbólumok 16
   12.1. A szimbólumok leírása 16
   12.2. A készülék címkézése 18
   12.3. A tartozékok címkézése 18
13. Hibaelhárítás 18

1. Műszaki adatok

Modellnév	**PressCare G280**
Termék neve	Lábmasszírozó
Szín	Fekete
Méretek (H*Sz*M) mm	(172,5 × 133,5 × 71)
A készülék súlya (g)	745
Kijelző	LCD
Az eszköz anyaga	PC-ABS
Nyomás (mmHg)	40–180 (10-es lépésekben)
Kezelés időtartama (perc)	10 és 30 között állítható (5 perces lépésekben)
Felfújási mód	3
„Smart Area” funkció	14 kombináció
Max. nyomás (mmHg)	180
Tápellátás műszaki adatai	Gyártó: Xiamen Invcy Electronics Co., Ltd. Modell: IVP0950-2000G Bemenet: 100–240 VAC 50/60 Hz 0,5 A Kimenet: 9,5 V ⎓ , 2,0 A, 19,0 W
Akkumulátor műszaki adatai	Lítium-ion akkumulátor 7,4 Vdc, 3500 mAh, 25,9 Wh

1.1. Termékleírás

PressCare G280	
	1. PressCare G280 készülék 2. Csatlakozó 3. Rugalmas csövek 4. Láb mandzsetta cipzár 5. Légkamrák

PressCare G280 készülék – Kezelőfelület és vezérlők	
	1. LCD-képernyő 2. „Be/Ki” gomb 3. „Start/Pause” gomb 4. „Program” gomb 5. Légtömlő csatlakozók 6. Tápcsatlakozó 7. „Nyomás növelése/csökkentése” gombok 8. „Terület” gomb 9. „Idő” gomb 10. Akkumulátor-jelző

1.2. Termékváltozatok

REF	Változat leírása
G7997	PressCare G280 S
G7998	PressCare G280 M
G7999	PressCare G280 L

1.3. Üzemi feltételek

Hőmérséklet	-10 °C és +45 °C között
Relatív páratartalom	max. 90 %
Nyomás	86 kPa-tól 105 kPa-ig

1.4. Tárolási, kezelési és szállítási feltételek

Hőmérséklet	-10 °C és +60 °C között
Relatív páratartalom	max. 90 %
Nyomás	86 kPa – 105 kPa

2. Garanciális feltételek

A készülékre az első felhasználó számára a vásárlás napjától számított huszonnégy (24) hónapos garancia vonatkozik az anyag- vagy gyártási hibákra, illetve tizenkét (12) hónapos garancia, ha a felhasználó azt szakmai célokra használja, feltéve, hogy a készüléket megfelelően használják és normál működési állapotban tartják.
A jótállás érvényessége az alábbi esetekben korlátozott:
- hat (6) hónap a kopásnak kitett mellékelt tartozékokra, például hálózati adapterekre, kábelekre, láb- és kar mandzsettákra, hasi övekre, csatlakozókra és akkumulátorokra.
Ez a jótállás abban az országban érvényes és hatályos, ahol a terméket megvásárolták. Ha a terméket az Európai Unió bármely országában vásárolták, a jótállás minden tagállamban érvényben marad. A jótállási szolgáltatás igénybevételéhez a felhasználónak be kell tartania a következő jótállási feltételeket:
1. A termékeket a javításra az ügyfél költségére, eredeti csomagolásukban és az összes eredeti tartozékkal együtt kell elküldeni.
2. A termékgarancia feltétele a termék vásárlásának dátumát igazoló vásárlási igazolás (nyugta, vásárlási bizonylat vagy számla) bemutatása.
3. A javítás nem befolyásolja a jótállás eredeti lejárati dátumát, és nem eredményezi annak megújítását vagy meghosszabbítását.
4. Amennyiben a javítási folyamat során nem állapítanak meg hibát a termékben, a műszaki vizsgálattal kapcsolatos költségeket akkor is felszámítják.
5. A jótállás érvényét veszti, ha a hiba oka: ütések, leejtés, a termék helytelen vagy nem rendeltetésszerű használata, nem eredeti külső tápegység/töltő használata, véletlen események, a termék átalakítása, a jótállási plombák eltávolítása vagy meghamisítása és/vagy a termék meghamisítása. Ezen felül a jótállás nem terjed ki a szállítás során, nem megfelelő csomagolás használata miatt bekövetkezett károkra (lásd az 1. pontot).
6. A jótállás nem terjed ki a termék használhatatlanságára, egyéb járulékos vagy következményes költségekre, illetve a vásárló által felmerült egyéb kiadásokra.
Megjegyzés: Mielőtt a készüléket javításra visszaküldené, javasoljuk, hogy olvassa el a használati útmutatóban szereplő utasításokat, és keresse fel a Globus weboldalát.
Ha a terméket szervizbe kell küldenie, kérjük, vegye fel a kapcsolatot kereskedőjével vagy a Globus ügyfélszolgálatával.

3. Javasolt felhasználás

A PressCare G280 sorozatú készülékek a szépségápolási, sport- és személyes wellness-ágazatokban való használatra készültek. A készülék helyes használatához kérjük, olvassa el a kézikönyvet. Az ajánlott felhasználási területeket az alábbiakban soroljuk fel.
SPORT
• Csökkenti a fáradtságot
• Ellazítja az izmokat
• Segíti a regenerációt edzés után vagy egymást követő edzések között

• Optimalizálja a bemelegítést a teljesítmény javítása érdekében

JÓLÉT

• Serkenti a mikrokeringést
• Csökkenti a nehézláb érzést
• Elősegíti a jó közérzetet
• Csökkenti az izomfájdalmat

SZÉPSÉG

• Serkenti a vízelvezetést
• Csökkenti a duzzanat érzését
• Harcol a vízvisszatartás ellen
• Javítja az alakot

4. A készülékek besorolása

A készülékek megfelelnek:
• az általános termékbiztonságról szóló (EU) 2023/988 rendeletnek
• az elektromágneses összeférhetőségről szóló irányelv (2014/30/EU)
• A veszélyes anyagok használatának korlátozásáról szóló irányelv (RoHS 2011/65/EU), beleértve az (EU) 2015/863 módosítást is.

5. Figyelmeztetések és ellenjavallatok

5.1. Kötelező viselkedés

Kérjük, olvassa el figyelmesen a teljes használati útmutatót, mielőtt a készüléket, annak részegységeit vagy tartozékait használná. Az útmutatót megfelelő helyen, mindenképpen a készülék használatának helyszínén tárolja.
A maximális biztonság érdekében a felhasználónak a használati útmutatóban meghatározott utasításoknak és működési korlátoknak megfelelően kell üzemeltetnie a készüléket.
A gyártó írásbeli engedélye nélkül tilos a jelen kézikönyvben szereplő szövegek és/vagy fényképek bármilyen formában, akár részben is, bármilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel történő sokszorosítása.
A készüléket kizárólag a Domino s.r.l. által szállított tartozékokkal szabad használni.
A készüléket gyermekektől elzárva kell tartani.

5.2. Használat előtti óvintézkedések

A készülék átvételekor ellenőrizze a csomagolás sértetlenségét, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a csomagolás nem sérült-e meg.

Ha a készüléket más berendezések közelében vagy azok tetején kell használni, ellenőrizze, hogy azok megfelelően működnek-e.
Ha a burkolat, a kábel vagy a tápegység csatlakozója kopás vagy sérülés jeleit mutatja, azonnal cserélje ki.
Győződjön meg arról, hogy a felhasználónál nem áll fenn a „Ellenjavallatok" szakaszban felsorolt állapotok közül egy sem.
Minden használat előtt ellenőrizze a készülék és tartozékai állapotát (ez elengedhetetlen a kezelés elvégzéséhez).
Nem vállalunk felelősséget a jelen kézikönyvben meghatározott utasításoktól és irányelvektől eltérő használatért.

5.3. Használat közbeni óvintézkedések

A készülék használata során bizonyos óvintézkedéseket be kell tartani.
- A kábeleket és csatlakozókat tilos a személy nyakára tekerni, hogy elkerülhető legyen a fojtogatás vagy fulladás veszélye.
- Használat közben tartsa a készüléket fedetlenül, és gondoskodjon a környék megfelelő szellőzéséről.
- Gondoskodjon arról, hogy a csatlakozócsövek ne legyenek elzárva, így biztosítva a légkamrákba történő megfelelő levegőáramlást.
- A készülék és részegységei nem védettek a folyadékok behatolása ellen: ne öntsön folyadékot a készülékre vagy annak részegységeire.
- A mobil és vezetékes rádiókommunikációs berendezések befolyásolhatják a készülék működését.
- A készüléket gyúlékony folyadékok közelében tilos használni.
- A készüléket száraz helyen tárolja.

5.4. Ellenjavallatok

Abszolút ellenjavallatok
A kompresszió terápia alkalmazása az alábbi esetekben ellenjavallt:
1. Mélyvénás trombózis (DVT)
2. Akut tromboflebitis
3. Friss tüdőembólia
4. Akut helyi fertőzések (fertőző cellulitisz, orbánc, bakteriális bőrfertőzések)
5. Súlyos pangásos szívelégtelenség
6. Tüdőödéma
7. Súlyos artériás ischaemia (előrehaladott perifériás artériás betegség, pl. ABI < 0,5)
8. Aktív rosszindulatú daganat a kezelt területen (különösen a nyirokrendszerben, ha azt orvos nem kezeli).

Relatív ellenjavallatok
A kompresszió terápiát az alábbi esetekben csak óvatosan vagy orvosi felügyelet mellett szabad alkalmazni:

1. Kezeletlen artériás magas vérnyomás
2. Kifejezett kapilláris törékenység
3. Szívödéma
4. Érzékelési zavarok (diabéteszes neuropátia, csökkent fájdalomérzékelés)
5. Terhesség
6. Nagyon fájdalmas visszerek
7. Nyitott sebek vagy bőrgyulladás
8. Nem diagnosztizált limfedéma.

5.5. Mellékhatások

Mellékhatásokról nem számoltak be. Bizonyos esetekben, ha nem kiegészítő terápiákkal együtt alkalmazzák, előfordulhat az ödéma megkeményedése és krónikus gyulladás.

6. A hatás elve

A kompresszió terápia nem egyszerű mechanikus kezelés, hanem a szövetek revitalizálására tervezett, precíz, **szekvenciális pneumatikus kompressziós** módszer. Ritmikus, körülölelő nyomáshullámok segítségével a készülék drénáló masszázst végez a végtagokban lévő folyadékokon, jótékony hatást gyakorolva mind a vénás, mind a nyirokkeringésre, és az egész testben azonnali enyhe könnyedségérzetet keltve.

Kompresszió terápia a sportban

A sport területén a kompresszió terápia elengedhetetlen segítőtársnak bizonyul **az edzés utáni regenerációban**. Egy edzés vagy verseny után az alsó végtagok általában duzzadtabbnak tűnnek, és a nehézségérzet is erősebb: egy célzott kezelés felgyorsítja az **izomregenerációs** folyamatokat, rövid időn belül helyreállítva az izmok rugalmasságát és reagálóképességét.

Alkalmazási protokoll

A maximális hatékonyság és a test fiziológiájának tiszteletben tartása érdekében a kezelés ciklus szigorúan követi a folyadékok természetes áramlását **distális-proximális irányban** (a végtagoktól a szív felé).

A kezelés menete

A **láb mandzsetták** felhelyezése után a nyomás a talptól indul, és simán, egyenletesen emelkedik az ágyék felé. A **hasi öv** használata esetén: a felfújás a felső kamrából indul, majd fokozatosan halad lefelé az ágyékhoz közelebb eső kamrák felé.

7. Felszerelés és kiegészítők

A PressCare termékeket láb mandzsettákkal és csatlakozókkal együtt szállítjuk: ezért a csomagolás felnyitása után kérjük, ellenőrizze, hogy a standard készlet teljes-e. Ha bármelyik alkatrész hiányzik, kérjük, vegye fel a kapcsolatot azzal a hivatalos kereskedővel, akitől a terméket vásárolta.

7.1. Alapfelszerelés

1 db PressCare G280 készülék akkumulátorral
2 db láb mandzsetta beépített csatlakozókkal (S/M/L méretekben)
1 db PressCare G250/G280 tápegység
1 db PressCare G280 felhasználói kézikönyv



7.2. Kiegészítők

5 kamrás láb mandzsetta, kompatibilis a PressCare G250/G280 készülékekkel, mindkét lábra használható, három méretben (S/M/L) kapható. Anyag: nejlon, PVC csatlakozókkal.		
A – ÁGYÉKTŐL A SAROKIG terjedő hossz **B –** COM-KERÜLET **C – BOKA** kerület		
REF	**Terméknév**	**Termékleírás és méret**
G7962	Láb mandzsetta G250/G280 - S	ÁGYÉKTŐL A SAROKIG terjedő hossz: 75 cm COMB kerület: 76 cm BOKA kerület: 47 cm
G7963	Láb mandzsetta G250/G280 – M	ÁGYÉKTŐL A SAROKIG terjedő hossz: 86 cm COMB kerület: 80 cm BOKA kerület: 48 cm
G7964	Láb mandzsetta G250/G280 – L	ÁGYÉKTŐL A SAROKIG terjedő hossz: 97 cm COMB kerület: 84 cm BOKA kerület: 49 cm
G7968	G250/G280 toldalék – S	A bokánál körülbelül 7 cm-rel, a combnál pedig 9 cm-rel növeli a mandzsetta méretét.
G7969	G250/G280 toldalék – M	A bokánál körülbelül 7 cm-rel, a combnál pedig 9 cm-rel növeli a mandzsetta méretét.
G7970	G250/G280 toldalék – L	A bokánál körülbelül 7 cm-rel, a combnál pedig 9 cm-rel növeli a mandzsetta méretét.

G7971	Hasi öv a G250/G280/G400 készülékekhez	5 kamrás kiegészítő a has, a csípő és a fenék kezeléséhez. Kompatibilis a PressCare G250/G280/G400 készülékekkel. Egy méret mindenkinek megfelel. Méretek: (125 x 35) cm Anyag: nejlon, PVC csatlakozókkal.
G7972	Hasi öv toldalék	A tépőzáras rögzítésnek köszönhetően a hasi övhez rögzíthető, így javítva az illeszkedést. Egy méret mindenkinek megfelel. Méretek: (40 x 35) cm Anyag: nejlon.

8. Az eszköz használatra való előkészítése



Vegye ki a terméket és az alkatrészeket a csomagolásból. A csomagolóanyagokat tartsa gyermekektől elzárva, és ne dobja ki a természetbe.
A kezelés megkezdése előtt helyezze a készüléket sík felületre. Csatlakoztassa a tápegységet a készülékhez és a hálózathoz (ha nem kívánja a készüléket akkumulátoros üzemmódban használni).



A termék megfelelő működéséhez a felhasználónak fel kell vennie a mellékelt láb mandzsettákat, és mindkét rugalmas csövet csatlakoztatnia kell a vezérlőegységhez.
A láb mandzsetták felhelyezése: nyissa ki a cipzárt, vegye fel a láb mandzsettát, majd csukja be a cipzárt. Csatlakoztassa a láb mandzsetta rugalmas csövét a vezérlőegységhez, a csatlakozón lévő nyíl irányát követve.
Ha növelni kell a láb mandzsetták kerületét, rögzítse a toldalékokat (opcionális kiegészítőként kaphatók) a két cipzár segítségével.
A kezelés megkezdése előtt vegyen fel kényelmes testhelyzetet: üljön le, dőljön hátra vagy feküdjön le.

9. P -visszaállítási programok

A program leírása	A kamra felfújási sorrendje
A üzemmód **ENYHE AKTIVÁLÁS (bemelegítés):** A légkamrák egyenkénti, egymást követő felfújása, amely gyengéd masszázst eredményez, elősegítve a lábak ellazulását. ***Ideális**: a mindennapi kényelemhez, a nyugodt érzés visszanyeréséhez az intenzív edzések között, valamint egy revitalizáló masszázshoz verseny előtt.* **Ajánlott kezelési idő:** 20–30 perc	

B ÜZEMMÓD **MÉLY MASSZÁZS:** Az összes kamra egymást követő felfújása, majd egyidejű leeresztése. A kompresszió intenzívebb és átfogóbb, mélyebb hatásra és alakformáló hatásra lett kialakítva. ***Ideális:*** *intenzívebb és mélyebb masszázshoz* **Ajánlott kezelési idő:** 20–30 perc	
A-mód – B-mód **KOMBINÁLT SORREND:** A program ötvözi az A és a B üzemmód felfújási sorozatait, hogy teljes élményt nyújtson, amelyben az enyhe stimuláció és a mély kompresszió váltakozik. ***Ideális:*** *az általános jó közérzethez és a pihenés pillanataihoz.* **Ajánlott kezelési idő:** 25–35 perc	

9.1. A kezelés gyakorisága

Ajánlott heti gyakoriság

- Enyhe használat / karbantartás: heti 2–3 kezelés.
- Rendszeres használat / napi jólét: heti 3–5 kezelés.
- Intenzív használat (rövid ciklusok): hetente legfeljebb 5–6 kezelés, a rendelkezésre álló különböző programok váltogatásával.

Kezelési tippek

- Váltogassa a dinamikusabb kompressziós programokat (pl. MODE B) a fokozatosabb és pihentetőbb programokkal (pl. MODE A és a kombinált MODE A-B), hogy kényelmesebb legyen a kezelés és változatosabb legyen a stimuláció.
- A nyomásszintnek mindig kényelmesnek és jól elviselhetőnek kell lennie: a kompressziót hatékonynak kell érezni, de soha nem lehet fájdalmas vagy túlzottan intenzív.
- A kezelés végén célszerű néhány percig pihentető testhelyzetben maradni, ami elősegíti a kellemes jólétérzetet és az enyhe könnyedség érzését.
- Ha az érzékelt eredmény nem kielégítő, a kezelés megismételhető a következő napokban a beállítások fokozatos módosításával, az alkalmazási idő és/vagy a nyomásszint fokozatos növelésével, amíg meg nem találja az Ön igényeinek leginkább megfelelő beállítást.
- Ha kellemetlen érzést, fájdalmat vagy túlzott nyomásérzetet tapasztal, csökkentse a nyomásszintet, és fontolja meg a kezelés időtartamának fokozatos növelését, ügyelve arra, hogy a kezelés során végig kényelmesen érezze magát.

10. Használati utasítás

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a biztonsági óvintézkedéseket. A masszázs hatékonyságának növelése érdekében kérjük, a terméket az utasításoknak megfelelően használja.

Bekapcsolni és kikapcsolni: A készülék bekapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig.
A készülék memóriafunkcióval rendelkezik: bekapcsoláskor automatikusan visszahívja az utoljára használt beállításokat (nyomásszint, felfújási mód és kezelési időtartam); ezek lesznek az alapértelmezett beállítások a következő kezeléshez, és a kijelzőn maradnak, amíg új parancsot nem ad; ebben a fázisban a „Program" felirat villog, amíg az újonnan kiválasztott program el nem indul.
A készülék kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot ismét 3 másodpercig.
FIGYELMEZTETÉS: ha nem indít el kezelést, a készülék 3 perc inaktivitás után automatikusan kikapcsol.
Programválasztás: a „Program" gomb megnyomásával megváltoztathatja a felfújási módot (MODE A, MODE B vagy MODE A-B).
Kamra kiválasztása: az „Area" gomb megnyomásával kiválaszthatja a kezelendő testrészt, majd egy vagy több kamrát felfújhat a teljesen személyre szabott kezelés érdekében. 14 különböző kamra-kombináció áll rendelkezésre.
Nyomásbeállítás: 15 nyomásszint áll rendelkezésre, 40 és 180 mmHg között (10 mmHg-es lépésekben). A masszázs intenzitásának beállításához használja a nyomásnövelő (+) és -csökkentő (-) gombokat. Javasoljuk, hogy az első használatkor állítsa be a nyomást körülbelül 40 mmHg-ra, majd szükség esetén fokozatosan növelje azt.
A kezelés időtartama: A „Time" gomb megnyomásával 5 perccel meghosszabbíthatja a kezelés időtartamát, minimum 10 perctől maximum 30 percig. Javasoljuk, hogy kezdjen rövid, 10 perces kezelésekkel, majd szükség esetén növelje az időtartamot a következő kezelések során.
A program elindítása és szüneteltetése: A láb mandzsetták felfújásának elindításához a kívánt program vagy a felfújandó kamrák kiválasztása után nyomja meg a „Start/Pause" gombot. A felfújás leállításához és az elért nyomás fenntartásához nyomja meg újra ugyanazt a gombot. A program szüneteltetésekor a „Program" felirat villog a kijelzőn. Ha a készülék 3 percen belül nem kap új parancsot, kikapcsol.
A kezelés befejezése: Használat után kapcsolja ki a készüléket, és válassza le mindkét láb mandzsettát a készülékről, hogy a levegő távozhasson a kamrákból.

11. Tisztítás és karbantartás

11.1. Tisztítás

1. A készülék vagy tartozékainak tisztítása előtt: kapcsolja ki a készüléket, és győződjön meg arról, hogy nincs csatlakoztatva a hálózathoz.
2. Ha piszkosak, tisztítsa meg a vezérlőegységet, a mandzsettákat és a tömlőket egy tiszta, nedves ruhával.
3. Alaposan szárítsa meg egy tiszta ruhával.
4. Ne engedje, hogy idegen tárgyak kerüljenek a tömlőkbe.
5. Ne merítse vízbe a kamrákat és az összekötő csöveket. Ne vegytisztítsa.

6. A készülék tisztításához ne használjon benzint, alkoholt, festékhígítót, oldószert vagy súroló hatású tisztítószert, mivel ezek meghibásodást okozhatnak, károsíthatják vagy elszínezhetik a részegységeket.
7. Ne hagyja, hogy szösz vagy por halmozódjon fel a vezérlőegységen vagy a tömlőcsatlakozásokon. Ha szösz vagy por halmozódik fel, használat előtt tisztítsa meg az egész rendszert egy száraz ruhával.

Mindig vegye figyelembe a kiegészítő címkéjén szereplő mosási szimbólumokat.

11.2. Tárolás

Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, száraz környezetben, közvetlen fénytől távol tárolja. Védje a készülékeket a portól, például az eredeti csomagolásban vagy hasonló csomagolásban tárolva. Ne helyezze a készülékeket gyújtóforrások vagy erős hőforrások közelébe. Kérjük, olvassa el az 5.1. Kötelező magatartás és az 1.4. Tárolási, kezelési és szállítási feltételek című szakaszokban található információkat is.

11.3. Hulladékkezelés

A terméket az Ön országában hatályos törvényeknek és rendeleteknek megfelelően kell ártalmatlanítani.

12. Címkézés és szimbólumok

12.1. A szimbólumok leírása

CE	A CE-jelölés azt jelzi, hogy a termék megfelel a (EU) 2023/988 rendelet követelményeinek.	**MADE IN PRC**	Jelzi, hogy a terméket a Kínai Népköztársaságban gyártották.
	Jelzi, hogy a készülék használata előtt el kell olvasni a használati utasítást.		Kötelező követelményt jelöl.
	WEEE (elektromos és elektronikus berendezések hulladéka) szimbólum. Ez azt jelzi, hogy a terméket nem szabad válogatatlan hulladékként ártalmatlanítani, hanem az újrahasznosítás és az		Jelzi, mely anyagokat kell újrahasznosítható hulladékként ártalmatlanítani.
			Ez azt jelzi, hogy a terméket a 2011/65/EK irányelvnek megfelelően gyártották.

	újrafeldolgozás céljából a kijelölt gyűjtőpontokra kell vinni. A WEEE jelölésnek minden, az EU piacára forgalomba hozott elektromos és elektronikus berendezésen szerepelnie kell.		Ez azt jelzi, hogy a készülék elektromos osztálya „II. osztály”.
	A gyártót azonosítja.		A gyártás dátumát jelzi.
	Meghatározza az importőrt.	**Terméknév**	A készülék technológiáját azonosítja.
REF	A termék cikkszámát jelzi.	SN	A termék sorozatszámát jelzi.
	A külső csomagoláson feltüntetve jelzi a termék szállítására, tárolására és megőrzésére vonatkozó hőmérsékleti tartományt.	**DC bemenet**	Meghatározza a készülék tápellátási értékeit.
	A külső csomagoláson feltüntetve jelzi a termék szállításához, tárolásához és megőrzéséhez szükséges relatív páratartalom-tartományt.	**Kimenet**	Meghatározza a készülék teljesítményét.
	A külső csomagoláson feltüntetve jelzi a termék szállításához, tárolásához és megőrzéséhez szükséges nyomástartományt.	**Egyenáramú tápegység**	A DC tápegység műszaki adatait, gyártóját és modelljét azonosítja.

12.2. készülékcímkézés



12.3. A tartozékok címkézése

CE	A készüléken található szimbólum jelzi, hogy az megfelel a hatályos irányelvek követelményeinek.		Ne mossa
KÍNAI GYÁRTÁS	Jelzi, hogy a terméket a Kínai Népköztársaságban gyártották.		Ne vasalja
REF	A termék cikkszámát jelzi.		Ne csavarja ki

13. Hibaelhárítás

Probléma	**Lehetséges ok**	**Megoldás**
A készülék nem működik, és a kijelző ki van kapcsolva.	1. A készülék nincs csatlakoztatva az áramellátáshoz. 2. A tápegység nincs csatlakoztatva a hálózathoz. 3. Nincs hálózati áramellátás.	1. Nyomja meg a bekapcsológombot a vezérlőegység bekapcsolásához. 2. Győződjön meg arról, hogy a tápegység megfelelően van-e csatlakoztatva a vezérlőegységhez és a fali csatlakozóhoz. 3. Ellenőrizze, hogy a fali csatlakozó működik-e.

A készülék képernyője be van kapcsolva, de a kamrák nem fújódnak fel.	1. Csak az egyik mandzsetta van csatlakoztatva a géphez. 2. A légtömlők nincsenek megfelelően csatlakoztatva. 3. A tömlők megsérültek.	1. Csatlakoztassa mindkét tömlőt. 2. Ellenőrizze, hogy a légtömlők megfelelően vannak-e csatlakoztatva. 3. Ellenőrizze, hogy a tömlők nem szivárognak-e, és győződjön meg arról, hogy nincsenek-e sérülve.
A felfújás működés közben leáll.	1. A légtömlők már nincsenek szorosan csatlakoztatva. 2. Szivárgás van a csövekből vagy a mandzsettákból. 3. A beállított programidő lejárt. 4. A készülék lemerült.	1. Ellenőrizze, hogy a légtömlők megfelelően vannak-e csatlakoztatva. 2. Ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás a csövekből vagy a lábvédőkből. 3. A készülék automatikusan kikapcsol, amikor a beállított idő letelt; szükség esetén nyomja meg a bekapcsológombot egy új kezelés elindításához. 4. Töltse fel a készüléket a termékhez mellékelt töltővel. Ha az akkumulátor meghibásodott: kérjük, vegye figyelembe, hogy az akkumulátort kizárólag az Domino Srl által felhatalmazott, szakképzett személyzet cserélheti ki. A szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, vegye fel a kapcsolatot azzal a kereskedővel, akitől a terméket vásárolta.

GLOBUS

ITALIAN EXCELLENCE

DOMINO S.R.L.

Via Vittorio Veneto, 52 - 31013 Codognè (TV) - ITALIA

(+39) 0438 7933

globuscorporation.com